

PROVEEDORA DE FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MATERIALES SA DE CV



**PROFACOM**  
 Proveedor de Fabricación y Comercialización de Materiales S.A. de CV


[Redacted Address]

No. de Factura <b>A1835</b>
Fecha de Documento <b>12/jun/2018 18:07:45</b>

Lugar de Expedición <b>72580</b>	Fecha de Certificación <b>12/jun/2018 18:18:18</b>	Folio del SAT <b>485473EC-7B1C-944F-A65C-95E8FF32399A</b>
Certificado Emisor <b>00001000000305582705</b>	Certificado SAT <b>00001000000401041203</b>	Régimen Fiscal Emisor <b>General de Ley Personas Morales</b>
Condiciones <b>CONTADO</b>	Pago en una sola exhibición	Clave O3 <b>Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos</b>
Vendedor		Orden de Compra

<b>Facturar a:</b>		
Nombre:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Código Postal: 90000
Dirección:	LIRA Y ORTEGA 42 CENTRO	Estado: PUE
Colonia:	CENTRO	
Ciudad:	PUEBLA	
R.F.C.:	ITL990930EA7	Teléfono: 01246-4620020

Artículo	Clave Fiscal	Descripción	Unidades	UM SAT	U.med.	Precio	Descto.	Importe
	56122000	LABORATORIO FITOPATOLOGIA QUE CONSTA DE: MESA CENTRAL PARA 10 PLAZAS CON TARJA CON ACCESORIOS LA MESA CENTRAL DEBERA SER DE 10 PLAZAS DOS CON W=336+64 D=112 H=90+43 DEBERA ESTAR FABRICADA CON ESTRUCTURA METALICA TIPO ASNILLA DE TUBULAR METALICO DE 1.25" X3# DE C.R CALIBRE 18 UNIDOS A BASE SOLDADURA CON MICRO ALAMBRE (PROCESO MIG) QUEDANDO PERFECTAMENTE PERFECTAMENTE TERMINADA SIN ESCORIAS Y DEBERA PASAR POR UN SISTEMA DE LAVADO A BASE DE FOSTATO MAS SELLO CROMICO, QUEDANDO LIBRES DE IMPUREZAS.ESTE PROCESO DE LAVADO PERMITIRA QUE SE HABRA EL PORO PARA UNA ADHESION DE LA PINTURA. LA PINTURA DEBERA SER ELECTROESTATTICA EPEXICA MICRO PULVERIZADA,HORNEADA A 200 GRADOS Y DEDBERA TENER UNA RESISTENCIA A LA SALANIDAD DE 130 HORAS EN CAMARA SALINAS.CUBIERTAS EN ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO TIPO 304 ANSI CALIBRE 18 CON ACABADO PULIDO N° 4 REFORZADO CON APLICACIÓN ANTI RUIDO BAJO CUBIERTA CON 2 ESCUDILLAS CENTRALES A LOS EXTREMOS. PUENTE ALTO DE 43 CMS ANCHO EN ACERO INOXIDABLE CAL TIPO 18 TIPO 304 ANSI PARA INSTALACIONES DE GAS,AGUA Y ELECTRICIDAD GABINETE FREGADERO METALICO FABRICADO EN LAMINA 0.76 X 0.03 X0.64 M.TAPA CENTRAL EN LAMINA GALVANIZADA BORDERIZADA DE 25 X 67 CM, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE T-304 CON REBORDE PERIMETRAL PA RA ESCURRIDO,CON UNA TARJA CENTRALDE 50 X 40 X25 CM.TAPA VISTA EN LAMINA GALVANIZADA BOR DERIZADA DE 1.00 X0.08 X 0.86 M COLOCACION PERPENDICULAR A ME SA YA CCESORIO, ESCURRIDOREN ACERO INOXIDABLE CON 33 VASTAGOS TIPO ESPIGA Y CHAROLA INTEGRADA	3	H87	Pieza	302,500.00		907,500.00

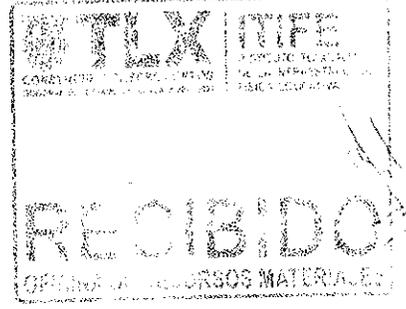

SE TIENEN CUATRO RENGLONES CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.


Importe total con letra	*****
Observaciones	*****

No. de Factura <b>A1835</b>	
Fecha de Documento <b>12/jun/2018 18:07:45</b>	

Lugar de Expedición	Fecha de Certificación	Folio del SAT
Certificado Emisor	Certificado SAT	Régimen Fiscal Emisor
Condiciones CONTADO		
Vendedor	Orden de Compra	

**Facturar a:**  
**Nombre:** INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
**Dirección:** LIRA Y ORTEGA 42 CENTRO  
**Colonia:** CENTRO  
**Ciudad:** PUEBLA  
**R.F.C.** ITL990930EA7 **Teléfono:** 01246-4620020

Artículo	Clave Fiscal	Descripción	Unidades	UM SAT	U.med.	Precio	Desclo.	Importe
23152200	MESA	PARA ESCURRIDOS DEBERAN DE CONTAR CON UN KIT DE 12 LLAVES DE PITON PARA AGUA Y AIRE Y GAS IMPORTACION, 1 LLAVE CUELLO DE GANSO PARA AGUA FRIA CONTRA CANASTA Y CESPOL PARA FREGADERO, 4 CONTACTOS DOBLES DE 110 VAC RAMALES DE TUBERIA Y NIPLES DE COBRE TIPO "M" EN 1/2" PARA SERVICIO DE AGUA CONECTADAS A 2 LLAVES DE AGUA CONECTADAS EN SUS RESPECTIVAS ESCUDILLAS DE CUBIERTA Y DOS CONTRA REJILLA DE 38 MM CESPOL FLEXIBLE. MARCA COBRAMEX  PARA BALANZAS AREA PARA BALANZA ANALITICA DE 0.90 X 0.64 X 0.90 H CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CAL 18, SOPORTE PARA BALANZA CON 12 PELOTAS DE GOLF 4 MEDIAS ESFERAS FILTRO Y PLACA DE MARMOL DE 0.5 X 0.4 M UNIDOS A BASE SOLDADURA CON MICRO ALAMBRE( PROCESO MIG) QUEDANDO PERFECTAMENTE TERMINADA SIN ESCORIAS Y DEBERA PASAR POR UN SISTEMA DE LAVADO A BASE DE FOSFATO MAS SELLO CROMICO QUEDANDO LIBRES DE GRASAS E IMPUREZAS . ESTE PROCESO DE LAVADO PERMITIRA QUE SE HABRA EL PORO PARA UNA MEJOR ADHESION DE LA PINTURA DEBERA SER ELECTROESTATICA EPOXICA MICRO PULVERIZADA HORNEADA A 200 GRADOS Y DEBERA TENER UNA RESISTNCIA DE SALINIDAD DE 130 HORAS EN CAMARA DE SALINAS,CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE AUTENTICA TIPO 304 ANSI CALIBRE 18 CON ACABADO PULIDO N° 4 REFORZADO. MARCA:COBRAMEX MODELO: BAL-256	1	H87	Pieza	46.800.00		46,800.00

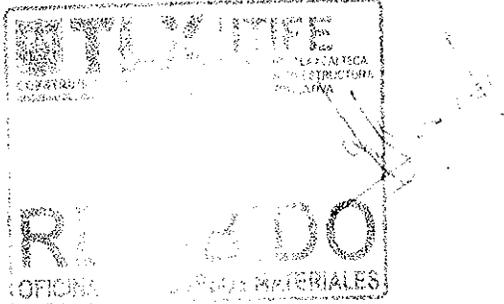

Importe total con letra	*****
Uso del CFDI:	*****
Observaciones	*****

No. de Factura

A1835

Fecha de Documento


12/jun/2018 18:07:45

Lugar de Expedición	Fecha de Certificación	Folio del SAT
Certificado Emisor	Certificado SAT	Régimen Fiscal Emisor
Condiciones CONTADO		
Vendedor	Orden de Compra	

Facturar a:

Nombre: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
Dirección: LIRA Y ORTEGA 42 CENTRO  
Colonia: CENTRO  
Ciudad: PUEBLA  
R.F.C. ITL990930EA7 Teléfono: 01246-4620020

Artículo	Clave Fiscal	Descripción	Unidades	UM SAT	U.med.	Precio	Desccto.	Importe
76111605	CAMPANA	<p>PROCEDENCIA : MEXICANA  ALFREDPO SANCHEZ VILLAGRAN  REPRESENTANTE LEGAL  GERENTE DE VENTAS</p> <p>DE EXTRACCION DE HUMOS 1.20 MCON LAS CARACTERISTICAS A CONTINUACION DESCRITA, EL CUERPO INTERIOR Y LA CUBIERTA ESTAN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, EL CUERPO EXTERIOR Y GABINETE SON DE LAMINA GALVANIZADA Y FOSFATIZADA CALIBRE 20 CON APLICACION DE PINTURA EN POLVO CUENTA CON SERVICIOS PARA AGUA Y GAS, VACIO Y ELECTRICIDAD CON SU RESPECTIVO CONTROL UBICADO AL FRENTE, PARA EL DESECHO DE LIQUIDOS CUENTA CON UNA ESCUDILLA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304 SU GUILLOTINA ES DE DE INASTILLABLE DE 6 MM CON MARCO DE ACCERO INOXIDABLE CONTRABALANCEADA, DEBERA DE INCLUIR LOS SIGUIENTES ACCESORIOS INCLUIDOS DE LINEA 2 TORRETAS CON CONTROL EXTERIOR (1 PARA AGUA, 1 PARA GAS , 1 LAMPARA A BASE DE TUBOS FLOURECENTES LUZ BLANCA Y 2 INTERRUPTORES ( 1 PARA LAMPARA, 1 PARA EXTRACTOR, 1 CONTACTO A.C DUPLEX POLARIZADO UN SISTEMA DE EXTRACCION INTEGRADO 3 METROS DE DUCTERIA PVC DE 8" 3 CODOS DE DUCTERIA ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE EXTRACTOR TAPA DE MOTOR, BASE DE FIERRO, BOQUILLA DE DESCARGA, DIMENSIONES EXTERIOR FRENTE: 120 CM FONDO 7 CM, ALTO 104 CM PARA ESTE LABORATORIO SERA NECESARIO QUE</p>	1	H87	Pieza	151,400.00		151,400.00

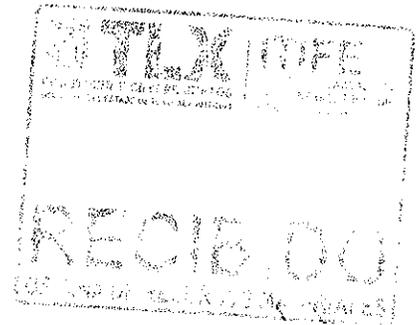

Importe total con letra	*****
Uso del CFDI:	*****
Observaciones	*****

No. de Factura

A1835

Fecha de Documento


12/jun/2018 18:07:45

Lugar de Expedición	Fecha de Certificación	Folio del SAT
Certificado Emisor	Certificado SAT	Régimen Fiscal Emisor
Condiciones CONTADO		
Vendedor	Orden de Compra	

Facturar a:

Nombre: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
Dirección: LIRA Y ORTEGA 42 CENTRO  
Colonia: CENTRO  
Ciudad: PUEBLA  
R.F.C. ITL990930EA7 Teléfono: 01246 4620020

Artículo	Clave Fiscal	Descripción	Unidades	UM SAT	U.med.	Precio	Desc.to.	Importe
41111702		<p>SE PRESENTE UN PLANO DE COMPOSICION Y DE SERVICIOS EN DONDE SE INDIQUE CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DICHO PLANO DEBERA DE REALIZARSE A LAS MEDIDAS REALES A ESCALA DEL LUGAR EN DONDE ESTARA UBICADO CADA LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD. SE EVALUARA LA MEJOR PROPUESTA ADEMÁS EL OFERENTE DEBERA OFERTAR SU OFERTA TECNICA EL ISO 9001:2008 DEL LICITANTE Y FABRICANTE DE MOBILIARIO SOLICITADO. EL RAMALEO DE SERVICIOS DEL MOBILIARIO DEBERA ENTREGARSE COMPLETAMENTE ARMADO Y INSTALADO SEGUN CORRESPONDA Y DEBERA ASEGURARSE DE INSTALAR CADA UNO DE LOS MUEBLES EN EL LABORATORIO APARTIR DE LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONARA LA ESCUELA.  *MARCA :COBRAMEX  MODELO:HU-004  PROCEDENCIA:MEXICANA</p>	5	H87	Pieza	35.800.00		179.000.00

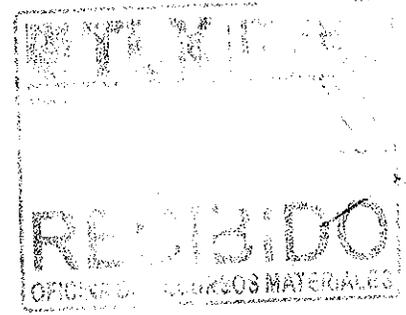

Importe total con letra
Uso del CFDI:
Observaciones

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

No. de Factura

A1835

Fecha de Documento


12/jun/2018 18:07:45

Lugar de Expedición	Fecha de Certificación	Folio del SAT
Certificado Emisor	Certificado SAT	Régimen Fiscal Emisor
Condiciones CONTADO		
Vendedor	Orden de Compra	

Facturar a:

Nombre: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
Dirección: LIRA Y ORTEGA 42 CENTRO  
Colonia: CENTRO  
Ciudad: PUEBLA  
R.F.C. ITL990930EA7 Teléfono: 01246 4620020

Artículo	Clave Fiscal	Descripción	Unidades	UM SAT	U.med.	Precio	Desccto.	Importe
		<p>LO REQUERIDO EL EQUIPO DEBERA SER UN MICROSCOPIO DE AUMENTO CONTINUO DE 0.7 A 4.5 X, (MAGNIFICACION DE 7 A 45). DEBERA TENER UN AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55 A 75 MM. CABEZA BINOCULAR INCLINADA A 45° GRADOS, EL SISTEMA DE GIRO DEL CABEZAL DEBERA DE SER A 360° EL AJUSTE DE DIOPTRIAS DEBERA DE SER DE MAS MENOS 6. EN AMBOS DEBERA DE CONTAR CON OCULARES HWF 10X/20MM, CON CUBRE OJOS DEBERA SER POSIBLE LA OBSERVACION SIMULTANEA DE AMBOS OCULARES PUERTO TRIOCULAR ESTATIVO DEBERA DE CONTAR CON UN SOPORTE DE BRAZO ARTICULADO CON ABRAZADORA AJUSTABLE. BALANCEADO, CON MOVIMIENTO ARRIBA Y ABAJO. HEAVY DUTY, CON TRES POSICIONES PARA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS CON LIBERTAD DE ESPACIO DEL TRABAJO, MOVIMIENTO HORIZONTAL DE 80 MM EL FABRICANTE DEBERA DE CUMPLIR CON EL ISO 13485/2003 EL CUAL DEBERA DE ADJUNTARSE A LA OFERTA TECNICA, DEBERA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE ENFOQUE MACRO ILUMINACION EN FORMA DE ANILLO DE LUZ LED CON CONTROL DE INTENSIDAD DE 0 AL 100% DISTRIBUCION CONTINUA DE LUZ LED A 360° CON 56 PUNTOS DE LED, DEBERA SER LIBRE DE SOMBRAS DEBERA TENER SALIDA DE 3.5 A 5.5 W CON 56 BULBOS DE LED LA DISTANCIA DE TRABAJO DEBERA SER DE 60 A 180 MM DEBERA CONTENER LENTES SUPLENMETARIOS BARLOW DE 0.5X Y DE 2.0 CON VIDEO CAMRA DIGITAL A COLOR TIPO CMOS DE 3.1 MP. CON PROGRAMA PRECARGADO Y ANALIZADOR DE IMAGENES PARA MEDIR LINEAS RECTAS ANGULOS CIRCULOS, EDITAR IMAGENES CAMBIAR DE COLOR HACER TABLAS DE DATOS ETC DEBERA CONTAR CON PUERTO USB 2.0 Y</p>						

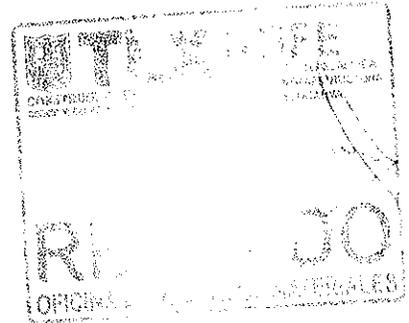

Importe total con letra
Uso del CFDI:
Observaciones

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

No. de Factura

A1835

Fecha de Documento


12/jun/2018 18:07:45

Lugar de Expedición	Fecha de Certificación	Folio del SAT
Certificado Emisor	Certificado SAT	Régimen Fiscal Emisor
Condiciones CONTADO		
Vendedor	Orden de Compra	

Facturar a:

Nombre: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
Dirección: LIRA Y ORTEGA 42 CENTRO  
Colonia: CENTRO  
Ciudad: PUEBLA  
R.F.C. ITL990930EA7 Teléfono: 01246 4620020

Artículo	Clave Fiscal	Descripción	Unidades	UM SAT	U.med.	Precio	Descto.	Importe
		<p>CABLE USB DEBERA DE SER COMPATIBLE CON WINDOWS (32/64BITES) XP/VISTA, 7,8 MAC OSX LINUX DEBERA INCLUIR LOS SIGUIENTES ACCESORIOS FUNDA DE PLASTICO, INSTRUCTIVO DE USO EN ESPAÑOL EN ESTUCHE DE POLIETILENO ESPUMA, LA RELACION DE ZOOM DEBERA DE SER DE 6.5:1 EL DIAMETRO DE CAMPO DEBERA DE SER DE 32.8 A 5.1 MM SE DEBERA DE PRESENTAR ADJUNTO A LA OFERTA TECNICA DE CERTIFICACION 9001-2008 DE LICITANTE. Y DEL FABRICANTE MARCA:COBRAMEX MODELO:LABO-78 PROCEDENCIA: MEXICANA</p>						
41111502		<p>BALANZA ANALITICA 220G DEBERA DE CONTAR CON APAGADO AUTOMATICO DEBERA ESTAR EQUIPADO CON UN TECLADO TACTIL. LAS IMPRESORAS DEBERAN LLEVAR TIEMPO Y FECHAS ADEMÁS OTROS DATOS SE PROPORCIONARAN PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL GLP A TRAVES DE LA CONEXION RS-232 O USB DEBERA DE TENER UNA CAPACIDAD DE 220G COMO MINIMO. DEBERA DE TENER REPETIBILIDAD DE 0.0001G Y UNA EXACTITUD DE 0.001G ADEMÁS DE UN MONITOR LCD RETRO ILUMINADO EL PLATO DEBE SER COMO MINIMO DE 5.7" Y CONTAR COMO MINIMO CON LAS SIGUIENTES</p>	1	H87	Pieza	46,200.00		46,200.00

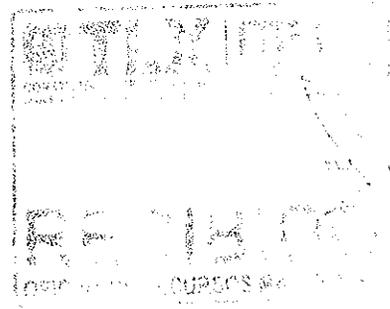

Importe total con letra
Uso del CFDI:
Observaciones

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

No. de Factura

A1835

Fecha de Documento


12/jun/2018 18:07:45

Lugar de Expedición	Fecha de Certificación	Folio del SAT
Certificado Emisor	Certificado SAT	Régimen Fiscal Emisor
Condiciones CONTADO		
Vendedor	Orden de Compra	

**Facturar a:**

Nombre: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
 Dirección: LIRA Y ORTEGA 42 CENTRO  
 Colonia: CENTRO  
 Ciudad: PUEBLA  
 R.F.C.: ITL990930EA7 Teléfono: 01246 4620020

Artículo	Clave Fiscal	Descripción	Unidades	UM SAT	U.med.	Precio	Desc.to.	Importe
		DIMENSIONES:ALTURA DE 3.5" ANCHO DE 8.7" Y PROFUNDIDAD DE 12.2" CON UNA POTENCIA DE 115 V Y BATERIA RECARGABLE ADEMAS DE INDICADOR DE BATERIA BAJA CON SALIDAS RS232 Y USB CON LA CONFIGURACION DE IDIOMA DE INGLES,ESPAÑOL, FRANCES,ALEMAN COMO MINIMO .G,KG,CT,GN,N,DR,LIBRA,ONZA,OZT,TPM,MM,TL TL,S,T DEBERA CONTAR CON CALIBRACION EXTERNA. MARCA:PRECISA MODELO:VE-303 PROCEDENCIA:MEXICANA						

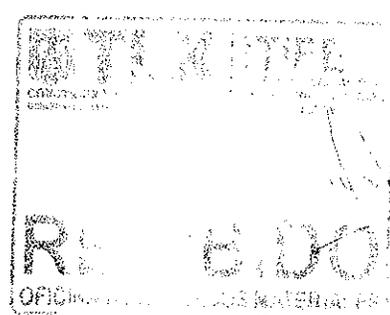

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|485473EC-7B1C-944F-A65C-95EB|F32399A|2018-06-12T18:18:18;SCD110105654|F|TzEC+uuUuLH6pWpqrQx25RG1B+SGmmuZo2QdeQ53bULP1R2XM8mantzw8Ykg5wtJ06sve3f1UDStyT3ovjh5XYZnepDEFYEWPDy0YsvkTslf2uDUcV7eVubD3V4BWjmAL1WUJGh8Cl/h7SA30rEEykeBTUbuYW3VjCp0M=[00001000000401041203|]

**Sello digital del CFDI:**

FIZeC+uuUuLH6pWpqrQx25RG1B+SGmmuZo2QdeQ53bULP1R2XM8mantzw8Ykg5wtJ06sve3f1UDStyT3ovjh5XYZnepDEFYEWPDy0YsvkTslf2uDUcV7eVubD3V4BWjmAL1WUJGh8Cl/h7SA30rEEykeBTUbuYW3VjCp0M=

**Sello digital del SAT:**

IRLHJBN5ahOCBKCX648ny21FN9BcG9mm7u/DJKyWglo5fT1u6QatEEFcGY5fQdH2H4lNM07NonmEn3paCamMpnWBhug50H4UxuC6bkap1cxYvB3mx)nWQIFY/MSamLbJA/MD3/7AjlEWGIG7gPJO22Wng9u1B70IvzWVv8Cj2YWKzr5Kkw+Vz6hz3e5x4yh/owaYf3Xx1lpIva47TSJEDfUMMdCYDw7RGI/CoblwnRZHUEmTQG2uVNGEVTXyzzpKCC71TXRA0gOQ0W3skng/BFF1n4aPNZJjNfy24xArGvZxv9rzVG09b2N2d82fLZzjnTqR/bIVXIS1LKg=

SUMINISTRO DE 1 LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE.  
 CCT29EPO0002B



Importe total con letra (Un millón quinientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)
Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancías
Observaciones

Subtotal	1,330,900.00
IVA 16%	212,944.00
<b>Total</b>	<b>1,543,844.00</b>